


Pfeiffer Vacuum 四重極質量分析計 セレクションガイド (スタート)

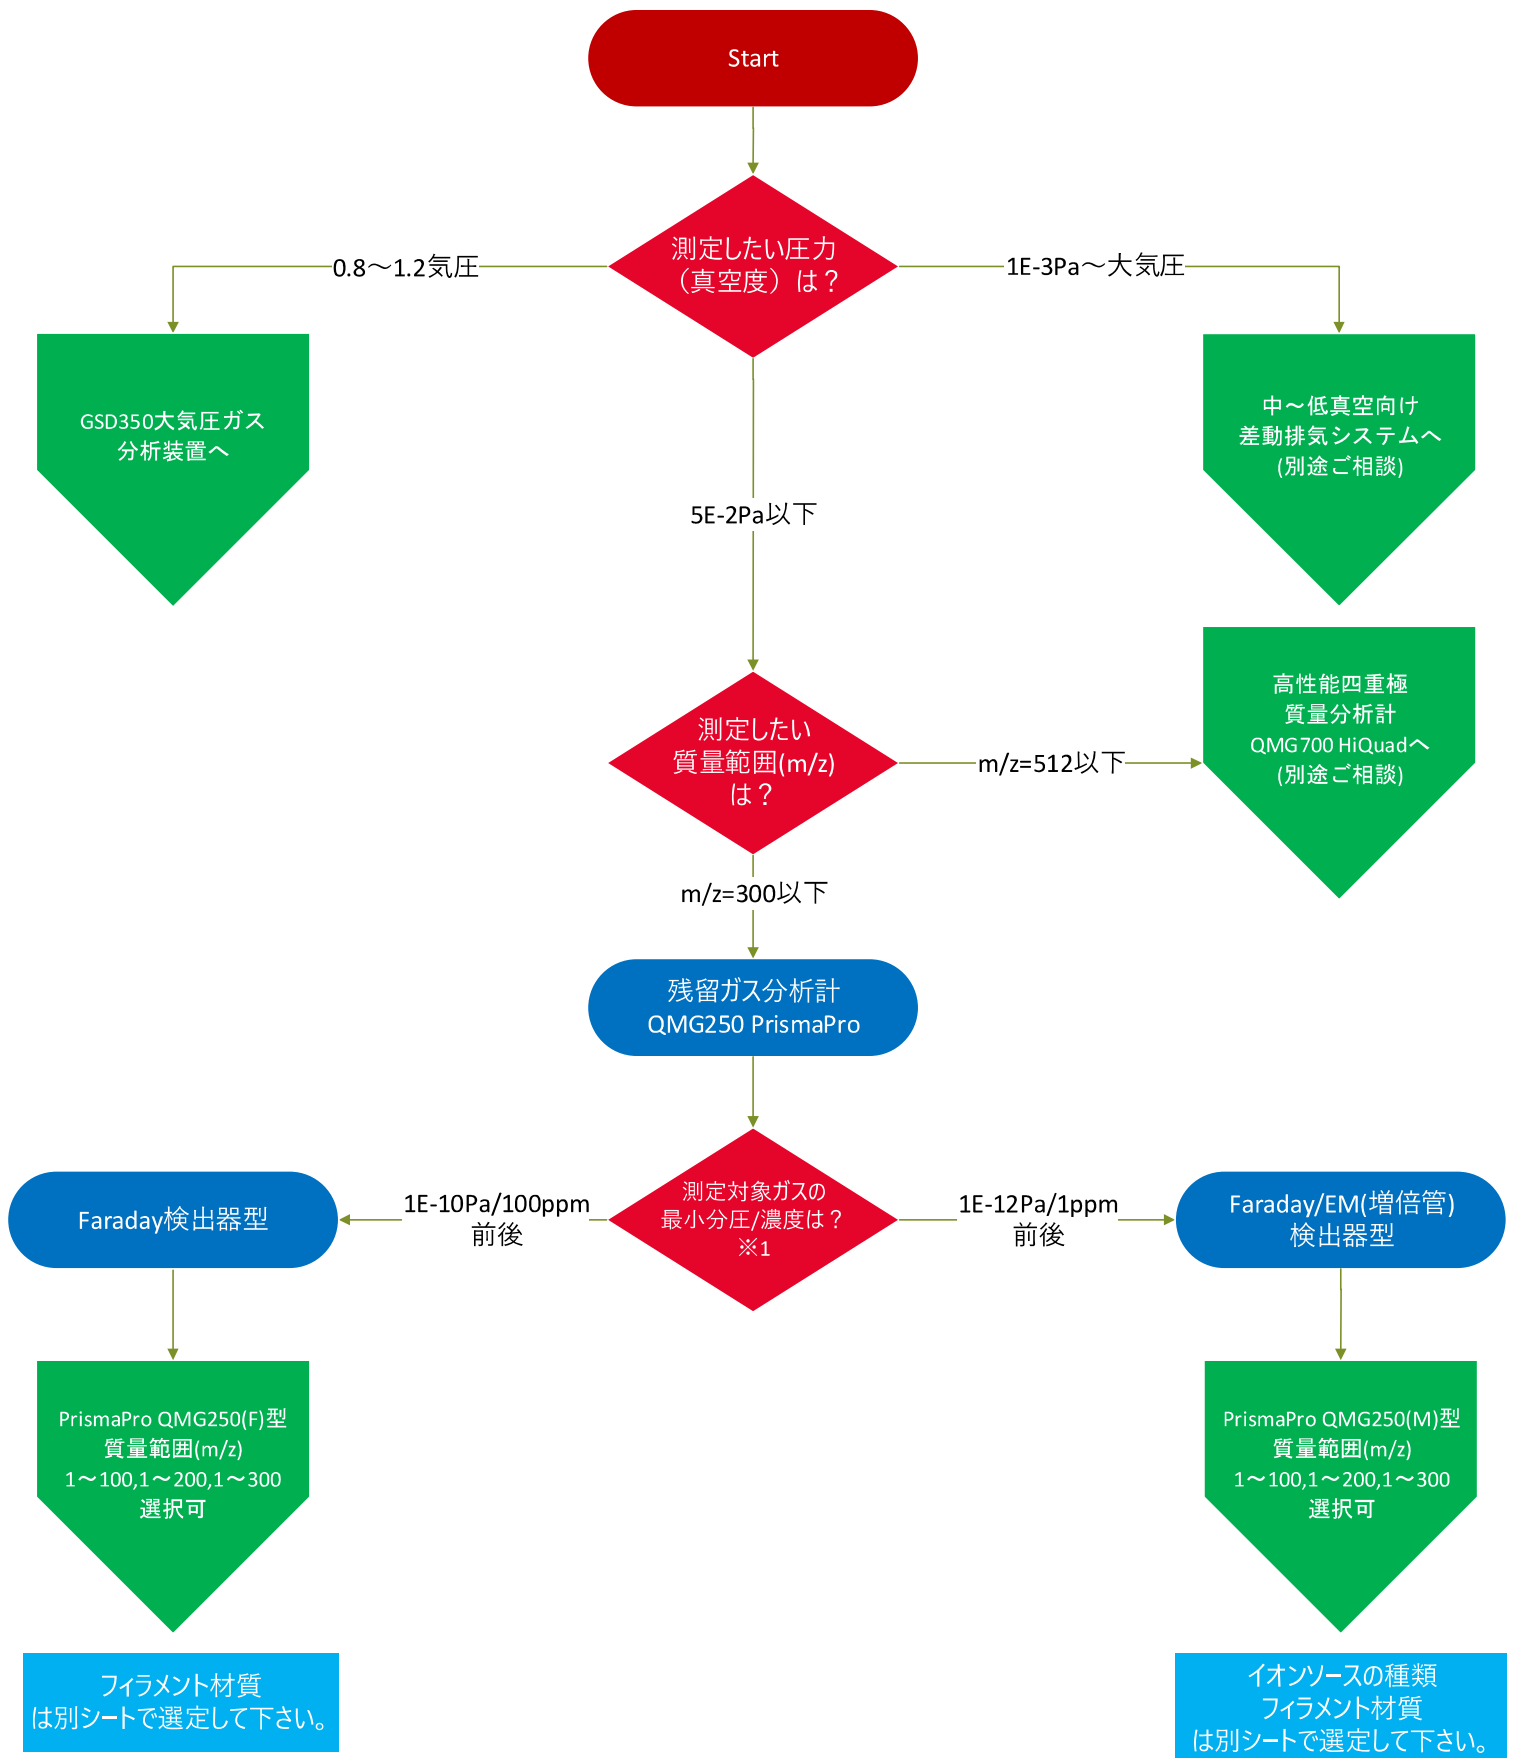


※1 最小検出分圧・濃度はガス種により異なります。

本セレクションは簡易的なガイドです。実際の機器選定は弊社担当者にご相談ください。


Pfeiffer Vacuum 四重極質量分析計 イオンソース・フィラメント セレクションガイド


注) イオンソース/フィラメントの選定には多様な要素があり、適性は相対的なものです。

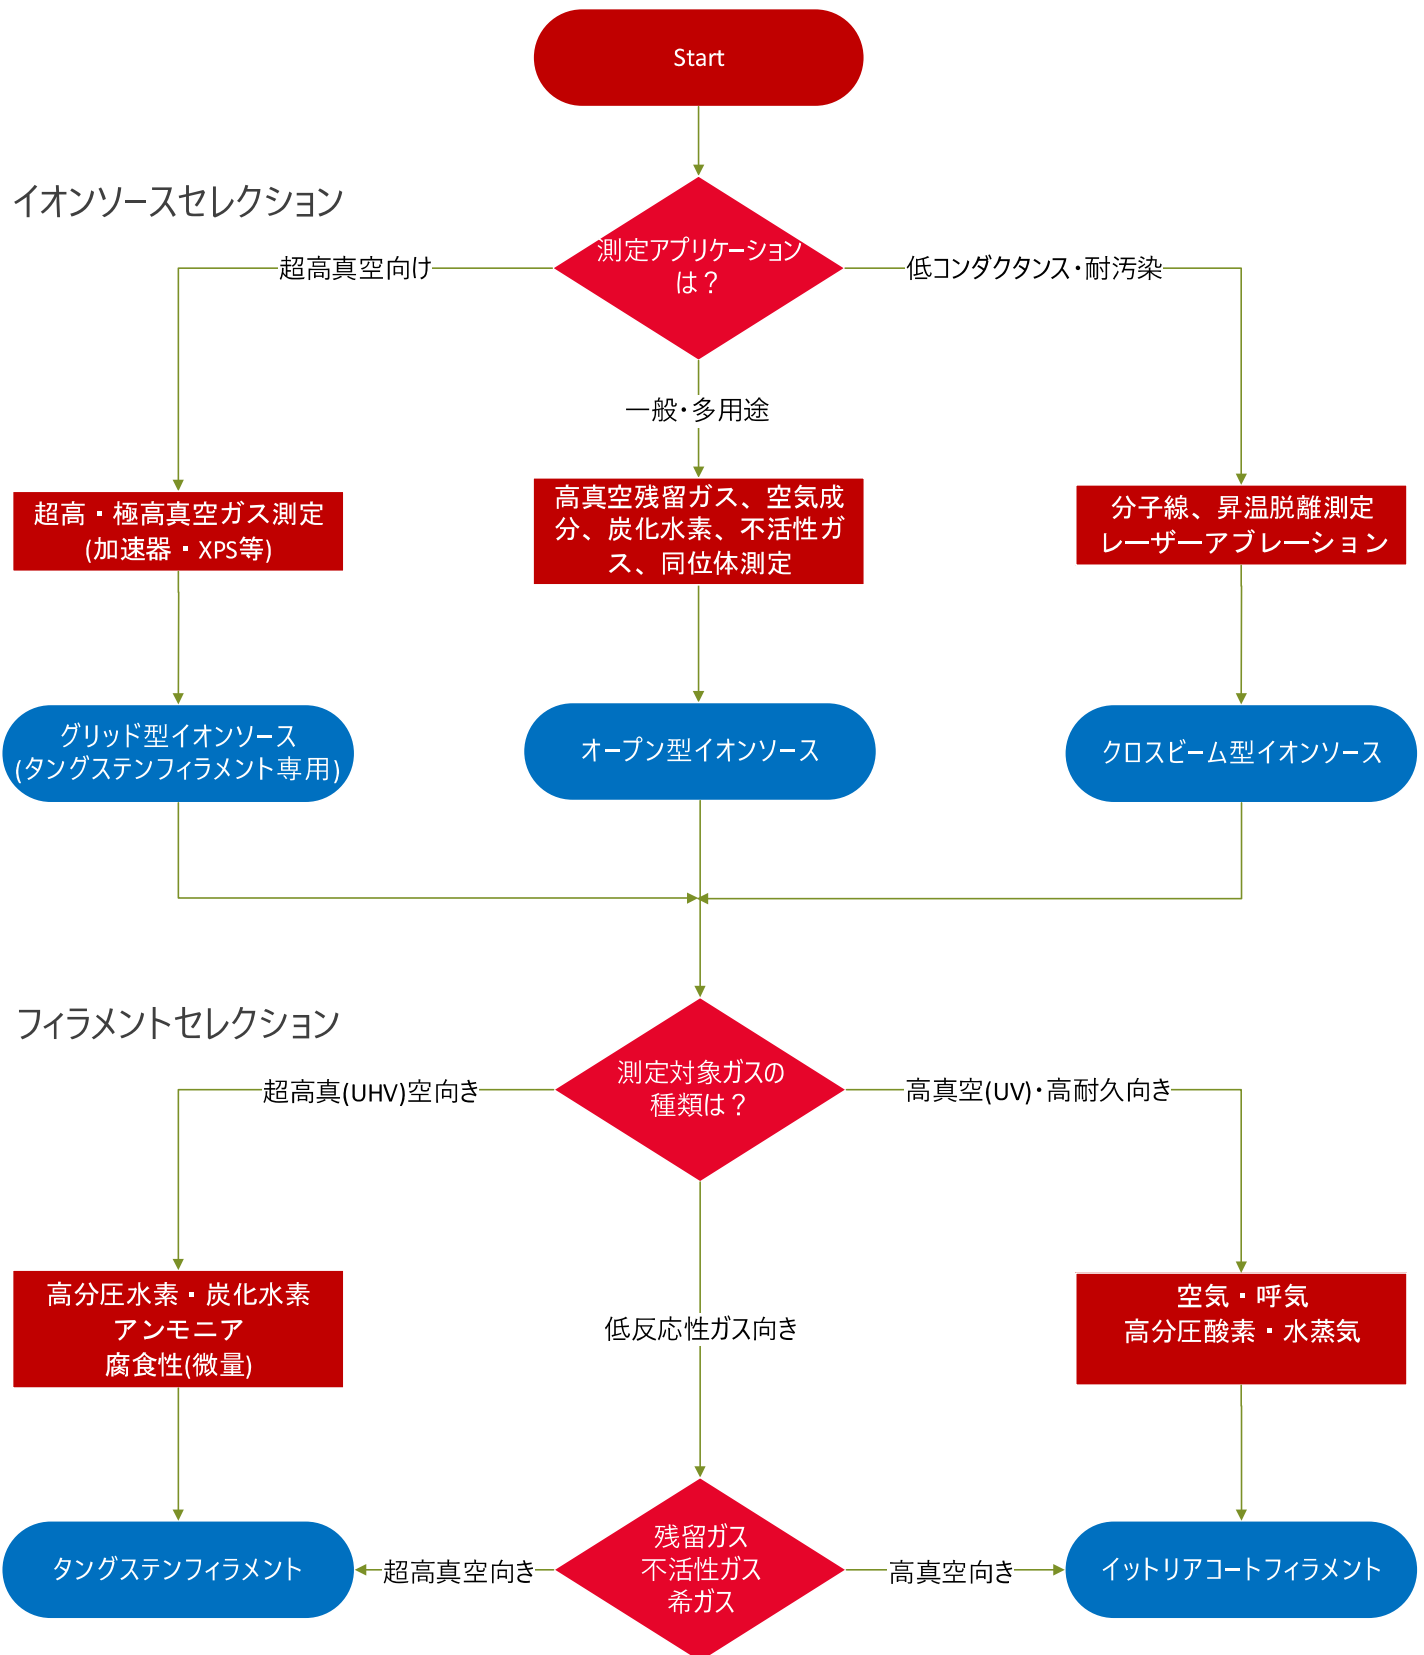

本セレクションは簡易的なガイドです。実際の機器選定は弊社担当者でご相談ください。

Pfeiffer Vacuum 四重極質量分析計 GSD350 セレクションガイド

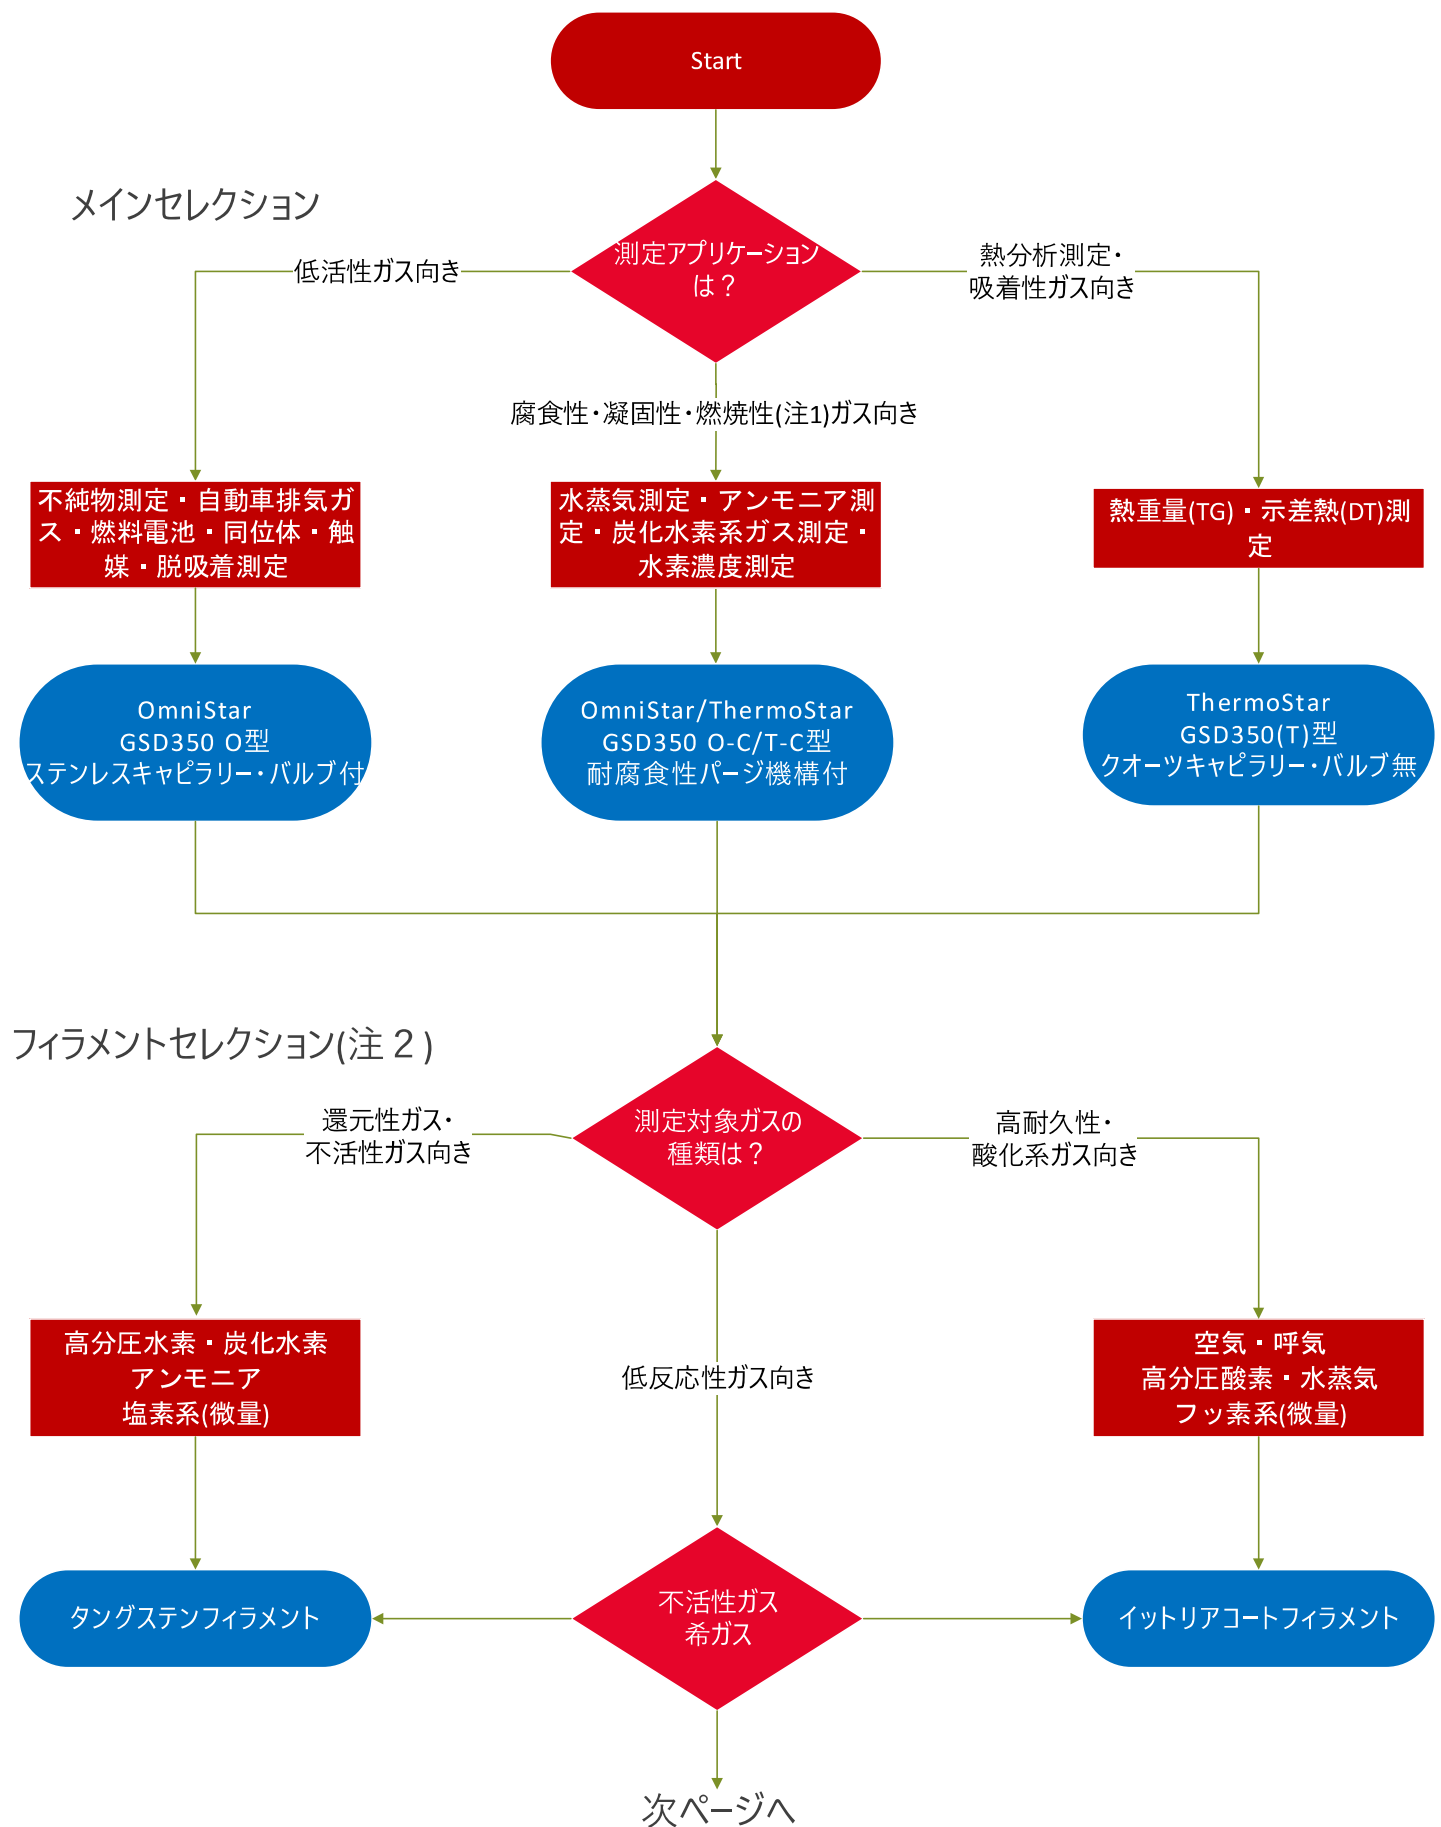

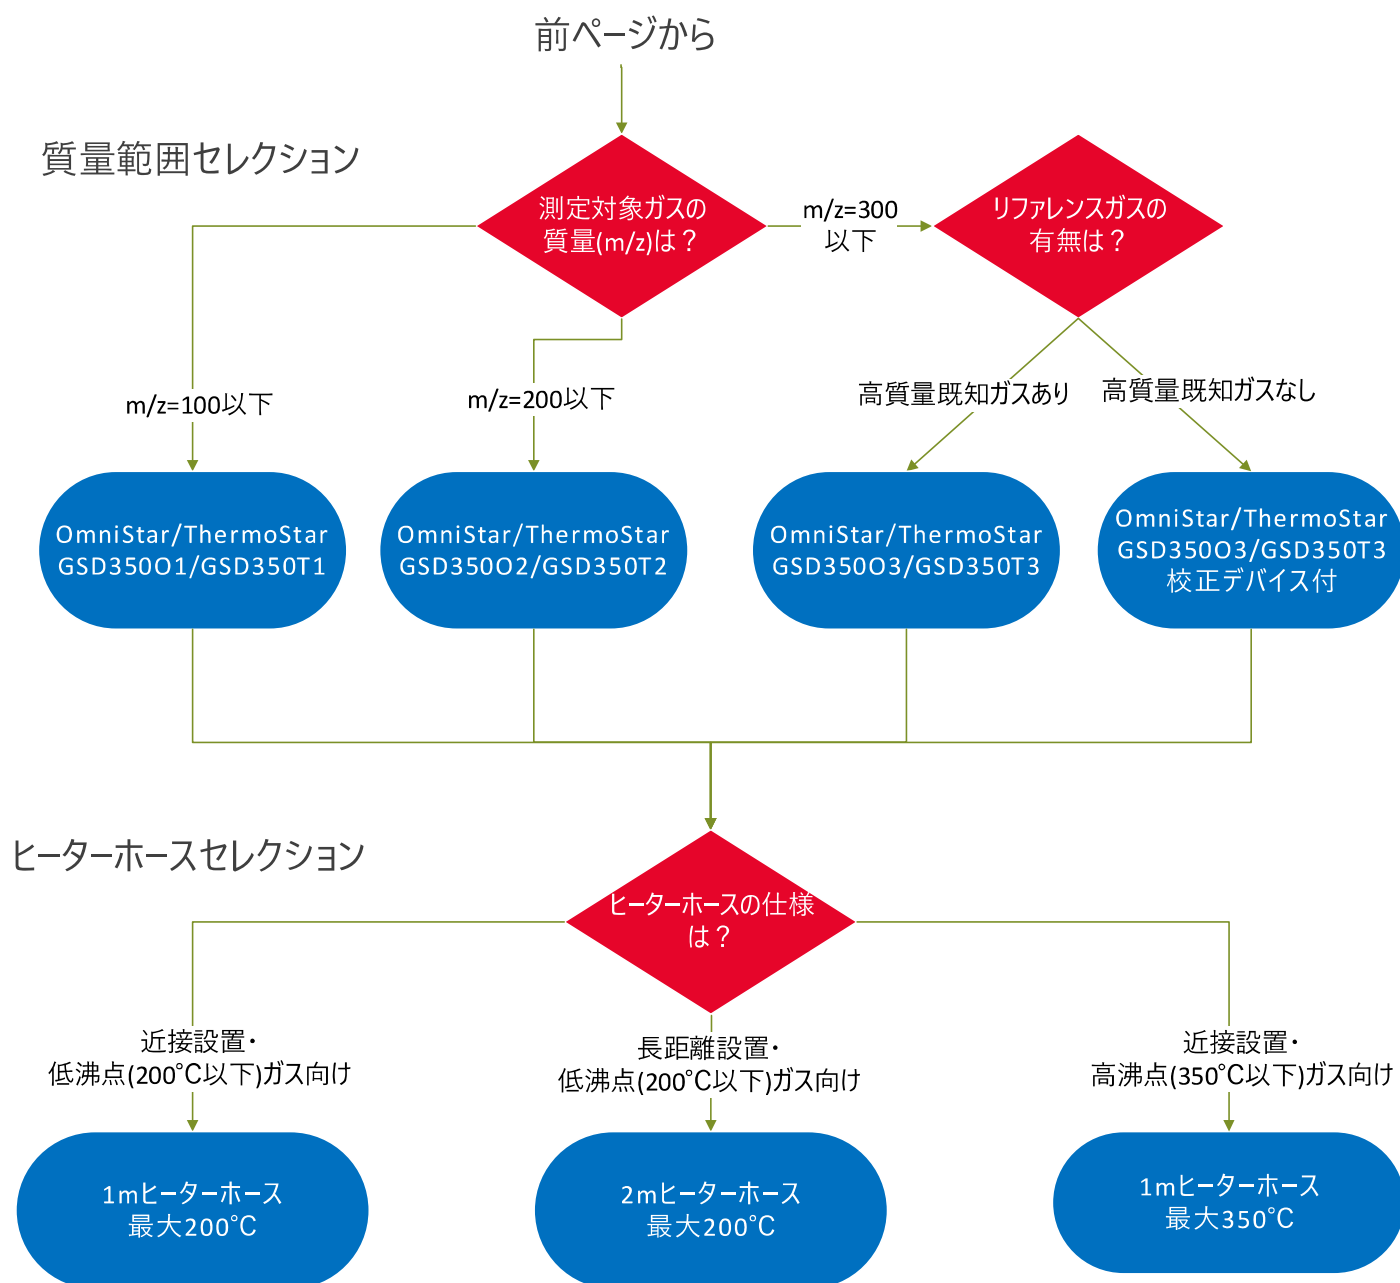

注 1) GSD350は燃焼性・爆発性ガス測定の安全性は担保されません。安全の確保は使用者にて行ってください。

注 2) フィラメントの選定には多様な要素があり、適性は相対的なものです。

本セレクションは簡易的なガイドです。実際の機器選定は弊社担当者にご相談ください。